

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ АД - ЛОВЕЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ПРЕДМЕТ: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ "Проф д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч"

Днес, *24.06.* 2014 година в град Ловеч се сключи настоящия договор между:

1 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ, представлявана от д-р Тихомир Иванов Бенев – изпълнителен директор на МБАЛ, в качеството си на орган по чл 7, т 3 от ЗОП, Валя Тодорова Райкова-гл счетоводител, с адрес гр Ловеч, ул "Съйко Съев" №27, ЕИК по БУЛСТАТ 110503990, наричана за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"** от една страна и от друга страна

2 „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, със седалище: град София, адрес на управление: ж к Младост 1, бл.28Б /ул „Димитър Моллов"/, регистриран в Търговски регистър с ЕИК 831641528, представлявано от Йонка Христова Гетова - Христанова, с ЕГН _____ наричана по долу накратко **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, на основание чл 41 от ЗОП и Решение от 27 05 2014 година на Възложителя, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави медицински изделия / общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни материали / за нуждите на МБАЛ "Проф д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции" наричани за краткост СТОКИ, по приложения списък (Приложение №1 за съответните спечелени от кандидата обособени позиции № 2, 8, 21, 32, 38, 44, 47, 52, 54, 55, 58, 62, 72, 75, 79, 82, 96, 111, 114, 116, 120, 133, 137, 140, 141, 146, 153, 154, 156, 160, 173, 175, 176, 177, 180, 181, 184, 188, 200, 203, 217, 221, 223, 225, 227, 229, 248, 345, 346, 351, 352, 355, 358, 374 и 382), предназначени за нуждите на МБАЛ АД- Ловеч

1 2 Настоящият договор влиза в сила от *24.06.* 2014 година

1 3 Срокът на договора е 12 месеца считано от датата на влизането му в сила

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ

2 1 Единичната цена на стоките по чл 1. с ДДС е посочена в Приложение №1 за стойност на единичните цени на стоките с ДДС, подадени в офертата при участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка за съответната обособена позиция и номенклатурни единици от нея

2 2 Цената на **СТОКАТА** по търговско наименование включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател, при срок на годност не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.


2 3 Цената е определена до краен получател и не превишава регистрираната цена на производител, плюс максимално допустимата надценка за търговец на едро, с включен ДДС

2 4 **Цената, посочена в офертата, неразделна част от настоящия договор е ПОСТОЯННА и не може да се променя до края на действие на този договор**

2 5 Общата прогнозна стойност на доставките по договора е 232 272 25 лв (двеста тридесет и две хиляди двеста седемдесет и два лева и 25 ст), без включен ДДС

2 6 Общата прогнозна стойност на доставките по договора е 278 726 70 лв (двеста седемдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и шест лева и 70 ст), с включен ДДС

2 7 Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 (шестдесет) дни съгласно чл 3, ал 5 от Закон за лечебните заведения , след представяне на следните документи:

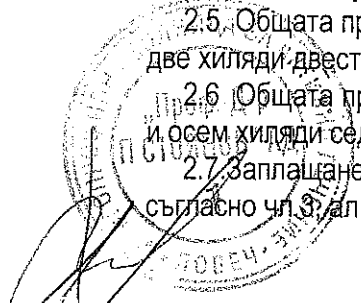

а) оригинална фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал и заверено копие;

б) приемателно - предавателни протоколи;

в) медицинските изделия да са придружени с декларация за съответствие от производителя от производителя или негов упълномощен представител

2.8 В случай, че посочените в чл 2.7 документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по чл 2.7 за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на последния изискуем се документ

2.9 Плащането на СТОКИТЕ се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез банков превод по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва: Банка: УниКредит Булбанк АД, гр София, клон Централен
BIC: UNCR BGSF, IBAN: E

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да доставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – СТОКИТЕ**, по количества точно по заявката за своя сметка до болничната аптека в сграда и помещения, посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

3.2. Да достави СТОКИ с търговско наименование съответстващо на подаденото в Техническата оферта.

3.3 Да достави СТОКИТЕ със срок на остатъчна годност не по – малко от 60 %

3.4. Качеството на стоките , предмет на настоящия договор ,следва да отговаря на техническите изисквания на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя.

3.5 Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на **СТОКИТЕ** предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя.

3.5.1 В случай на доставка на **СТОКИТЕ** с по – кратък от договорения срок на годност **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка, както следва:

- 59,99% - 50% - 10 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% - 20 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% - 40 % върху стойността на доставката;

3.5.2 Доставка на СТОКИ с остатъчен срок на годност по –малък от 30 на сто от обявения от производителя се извършва само с мотивирано решение на изпълнителния директор на МБАЛ АД и то за конкретно определено от него количество

3.5.3 Доставки на **СТОКИТЕ** с остатъчен срок на годност под 20% няма да бъдат заплащани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.6 Да доставя СТОКИТЕ, придружени с надлежни документи в оригинална опаковка и с ненарушена цялост


3.7 Да извърши доставката с грижата на добър търговец

3.8 Доставката на СТОКИТЕ се извършва до 48 /четиридесет и осем/ часа след направена писмена заявка В заявката **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя вида и броя на СТОКИТЕ, които желае да му бъдат доставени

3.9 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при невъзможност от доставка на заявените количества в срока по 3.8 веднага да изпрати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отказно писмо. Ако в срока по 3.8 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не получи заявените количества и не получи отказно писмо и това се повтори повече от два пъти, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора за съответните обособени позиции.

3.10 Ако по време на действие на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави заявените количества в срока по 3.8 , т е това се повтори повече от два пъти или повече от два пъти изпрати отказно писмо за невъзможност от извършване на доставка на заявените количества, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора едностранно за съответните обособени позиции

3.11 Доставянето на по – малки количества от заявените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** количества се счита за невъзможност от доставка и се приравнява на отказно писмо за недоставените количества и

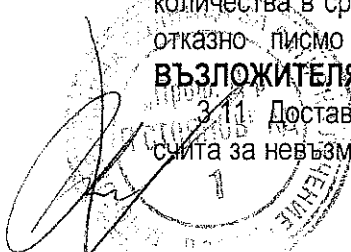

ако това се повтори повече от два пъти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да прекрати договора едностранно за съответните обособени позиции

3.12. При констатирането на дефектни и негодни за употреба медицински консумативи се прави съвместен констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като дефектните и негодни за употреба медицински изделия се заменят с нови такива

3.13. При доставяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на дефектни и негодни за употреба медицински консумативи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да прекрати договора едностранно за съответните обособени позиции, ако това се повтори два пъти

3.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** няма право да спира доставките поради просрочване на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за заплащането им след изтичане на срока на отложено плащане. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има правото да начисли законната лихва. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** спре доставките поради просрочване на задължението за заплащане, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да прекрати настоящия договор с едностранно писмено предизвестие

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. Да покаже на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** местата, на които да се извърши доставката на **СТОКИТЕ**

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и сроковете, определени в настоящия договор

4.3. Да получи и приеме доставените **СТОКИ** в срока по този договор и качество, отговарящо на стандартите за съответната **СТОКА** чрез подписване на приемо-предавателен протокол

4.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от изискванията за доставката на **СТОКИТЕ** от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество **СТОКИ**, както и да откаже за заплати съответната цена, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни своите задължения, съгласно договора

V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

5.1. Предаването и приемането на доставените **СТОКИ**, става с приемо-предавателен протокол, подписан от представител на **МБАЛ АД-Ловеч** и упълномощено лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 2 (два) екземпляра. Подписания протокол е основание за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да издаде фактура за доставените стоки

5.2. Рискът от погиване и повреждане на **СТОКИТЕ** се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до момента на подписване на протокола по т. 5.1

5.3. Преминаването на собствеността върху **СТОКИТЕ** става в момента на подписването на протокола от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява проверка на рекламираните **СТОКИ** от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол

5.5. Подписаната от представител на **МБАЛ АД – Ловеч** фактура се приравнява на приемо – предавателен протокол. Констатирани несъответствия при доставката се отстраняват след проверката на стоките по фактурата и допълнително уточнение с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е собственик на доставените **СТОКИ** от всяка доставка

6.2. Недостатъци, повреди, дефекти констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след получаване на **СТОКИТЕ** от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последния се задължава да съдейства на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването им

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 2% от прогнозната стойност на спечелените обособени позиции (Приложение №2-гаранция за съответните спечелени от кандидата обособени позиции № 2, 8, 21, 32, 38, 44, 47, 52, 54, 55, 58, 62, 72, 75, 79, 82, 98, 111, 114, 116, 120, 133, 137, 140, 141, 146, 153, 154, 156, 160, 173, 175, 176, 177, 180, 181, 184, 188, 200, 203, 217, 221, 223, 225, 227, 229, 248, 345, 346, 351, 352, 355, 358, 374 и 382) или общо 4 645 46

лв /четири хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и 46 ст /, която ще се освободи след неговото приключване.

7.2 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 5 /пет/ работни дни, след извършване на цялата доставка, в случай че са изпълнени задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, съгласно настоящия договор, чрез връщане сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

БАНКА: УниКредит Булбанк АД, гр София, клон Централен

ВІС: UNCR BGSF, **ІВАН:**

7.3 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

8.1 Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:

8.1.1 По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи обезщетение на другата

8.1.2 С изпълнението му

8.1.3 Ако изпълнението на договора стане невъзможно, поради независещи от страните причини
В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение

8.1.4 При прекратяване на юридическото лице **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, освен ако се даде съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник

8.1.5 При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.1.6 Едностранно с едноседмично предизвестие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при констатиране в течение на изпълнение на договора на нарушенията посочени 3.9, 3.10 и 3.11 от този договор

8.1.7 Едностранно с едноседмично предизвестие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако се установи, че по време на изпълнение на договора **СТОКИТЕ** предмет на този договор покажат дефект трайно повтарящ се при тяхната употреба в следствие на което същите стават негодни за употреба или крият риск от възникване на опасност за здравето на пациентите

8.2 При забава от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при заплащане на дължимото по настоящия договор възнаграждение, той дължи законната лихва върху сумата за периода на забавата

8.3 В случай на причиняване на вреда на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради причина, дължаща се на доставени некачествени **СТОКИ**, като отклонението от качеството е констатирано при потреблението им, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава за своя сметка да възстанови причинената вреда

8.4 В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** **СТОКИТЕ** в срока по 3.8. от този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на просрочената доставка, но не-повече от 10% от стойността недоставените **СТОКИ**. Сумата се удържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при изплащането ѝ по представената фактура

8.5 От **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при условията на точка 3.12 от този договор

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

9.1 Настоящият договор не може да бъде изменен и допълван с анекс

9.2 Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отразяването им по факс, и други, в случаите предвидени в договора

9.3 Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него, или с неговото нарушение, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението и неизпълнението му, ще се уреждат по взаимно споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно - по съдебен ред

9.4 Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица информацията, разменена по адрес на съвместните търговски преговори или предоставената под формата на оферти, спецификации и други.

9.5 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло

9.6 За неуредените въпроси по този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ЗОП и действащото законодателство на Република България

Неразделна част от този договор е:

- Приложение № 1 за стойност на единичните цени на стоките, подадени в процедурата за възлагане на обществена поръчка
- Приложение № 1 за гаранция за изпълнение по спечелените обособени позиции

Договорът се изготви в 3 /три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Съгласувано с юрист :

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗП. ДИРЕКТОР

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

/д-р Тихомир Бенев/

/Валя Райкова/

ДОГОВАРЯЩИ СЕ :


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ


/инж. Йонка Гетова-Христановна/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД


Об.поз.№	Номенклатура	Генерика/Група	Търговско наименование	Форма на продукта	Брой опаковки	Ед. цена за опаковка	*Обща стойност	Предлагана фабрична оп.	Количество	Ед. цена	Каталожен номер	Производител	Гаранция по обособената позиция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.Мини-слайк игли /стерилни/		Слайк стерилен KD Spike с филтър 0.1 мкм, зелено капаче	бр.	300	0.78	234.1		300	0.78	150772645	KDM-Германия	3.90
8	8.Дренаж гофриран силиконов 36/5см		Дренаж по Deibel Oesophageal catheter	бр.	900	7.86	7074.1		900	7.86	GA6106	Coloplast-Porges - Д	117.90
21	21.Сонда "Блякмор" №18		Сонда по Deibel Oesophageal catheter	бр.	10	89.4	894.1		10	89.4	LB7118	Coloplast-Porges - Д	14.90
32	32.Хартия за принтер на ехограф Sono-UPP-210HD 210mmx25m		Хартия за видеопринтер Sono-UPP-210HD 210mmx25m	бр.	10	94.8	948.1		10	94.8	11645	Seagata - Италия	15.80
38	38.Хартия за ЕКГ Cardi-max FX-7202 от Fukuda 110x140x142		Хартия за ЕКГ Cardi-max FX-7202 Fukuda 110x140x142	бр.	250	3.15	787.5.1		250	3.15	12693	Seagata - Италия	13.13
44	44.Еднократен комплект за катетеризация		Сет еднократен за катетеризация	бр.	1200	5.94	7128	1	1200	5.94	490-050	Bastos Viegas - Порт	118.80
47	47.Чаршаф еднократен за лапароскопска хирургия		Чаршаф еднократен за лапароскопска хирургия	бр.	100	21	2100.1		100	21	488-042	Bastos Viegas - Порт	35.00
52	52.Апарат за кръвно налягане - детски		Апарат за кръвно налягане - детски	бр.	5	31.2	156.1		5	31.2	1091921	HNH-Германия	2.60
54	54.Сет за аспирация с дължина 210см с твърдо огъната канюла с отвор - SN22		Сет аспирационен 210см , канюла с отвор - SN22	бр.	250	5.28	1320.1		250	5.28	608022	MPI-Германия	22.00
55	55.Бобчета Тулфери с рентгенопозитивна нишка 8x8		Тулфери с РКН 8x8	бр.	1	47.5	47.5.500		500	0.095	433-005	Bastos Viegas - Порт	0.79
58	58.Епруветки стерилни центрофужни		Епруветка, конична, градуирана с капаче, 10мл., стерилна	бр.	5	15.6	78.100		500	0.156	BSM408	Biosigma-Италия	1.30
62	62.Йозета стерилни за еднократна употреба 0,01мл		Йозе, еднократно, стерилно, 10мкрл.	бр.	100	0.6	60.10		1000	0.06	BSV1200	Biosigma-Италия	1.00
72	72.Наконечници стерилни за автоматична пилета 100 - 200мкп		Наконечници, жълти, стерилни, 5бр./оп.	бр.	40	0.475	19.5		200	0.095	BSR011	Biosigma-Италия	0.32
75	75.Пилети за СУЕ		Пилети, седиментационни	бр.	40	19.5	780.100		4000	0.195	952/0108	Biosigma-Италия	13.00
79	79.Пълни лампи		Крампи умбиликални	бр.	1100	0.42	462.1		1100	0.42	46000	MPI-Германия	7.70
82	82.Примка"дормия" SN 47/0см		Dormia basket	бр.	10	390	3900.1		10	390	DOR214	Coloplast-Porges - Д	65.00

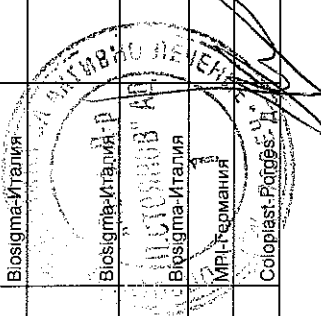

96	96. Шапка операционна с бръзки	Шапка операционна с бръзки	бр.	50	14.4	720	160	8000	0.09	461007	Bastos Viegas - Порту	12.00
111	111. Фолио за оперативно поле 45-55	Фолио операционно прозрачно стерилно EVRODEPM INCISE 45cm X 55cm	бр.	150	10.26	1539	1	150	10.26	717745	Eurofarm-Италия	25.65
114	114. Конец без игла с дебелина 2/0-дължина в опаковка 5x70 см	Марлин, виолет 5x70, 2/0	дуз.	60	104.64	6278.4	стер. оп./	60	104.64	17240327	Cat Gut-Германия	104.64
116	116. Резорбируем синтетичен плетен конец без игла - полигликолова киселина с покритие полипролактон и калциев стеарат-средносрочна резорбция 60-90 дни дебелина 2/0 дължина 45см в опаковка 6x45см. Лигатура	Марлин, виолет 6x45, 2/0	дуз.	20	84.24	1684.8	дуз. /12 стер. оп. по 6 бр. конца във	20	84.24	17240027	Cat Gut-Германия	28.08
120	120. Индикатор биологичен - ампули в опаковка от 100 бр.	Биологичен индикатор за контрол на стерилизация с пара - ампула	бр.	1	318	318	100 бр.	1	318	SCS 100	InformeMed, Полша	5.30
об.поз. №133 1	Стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна подложка 5см/7см	Стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна подложка EVROMED 5см/7см	бр.	1200	0.12	144	1	1200	0.12	718000	Eurofarm-Италия	2.40
об.поз. №133 2	Стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна подложка 10см/15см	Стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна подложка EVROMED 15см/8см	бр.	600	0.42	252	1	600	0.42	718005	Eurofarm-Италия	4.20
об.поз. №133 3	Стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна подложка 10см/20см	Стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна подложка EVROMED 20см/10см	бр.	600	0.57	342	1	600	0.57	718006	Eurofarm-Италия	5.70
об.поз. №133 4	Стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна подложка 10см/35см	Стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна подложка EVROMED 35см/10см	бр.	200	1.05	210	1	200	1.05	718011	Eurofarm-Италия	3.50
об.поз. №137 1	Спинални игли L75 №22	Игла спинална KD-Fine S 22G /0.7x88/	бр.	1200	1.14	1728	1	1200	1.44	150/900901	KDM, Германия	28.80

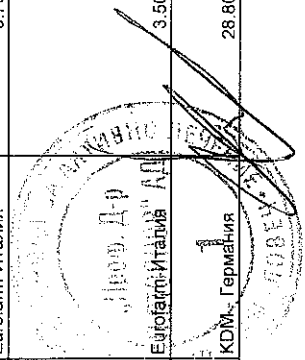


об.поз.№137 2	спинални игли /дълги/ №22	Игла спинална KD-Fine S 22G /0.7x88/	бр.	200	1.14	288 1	200	1.44 150/900901	KDM - Германия	4.80
об.поз.№137 3	спинални игли №18	Игла спинална KD-Fine S 18G /1.3x75/	бр.	100	1.14	144 1	100	1.44 150/900840	KDM - Германия	2.40
об.поз.№137 4	спинални игли №22	Игла спинална KD-Fine S 22G /0.7x40/	бр.	120	1.14	172.8 1	120	1.44 150/900918	KDM - Германия	2.88
об.поз.№137 5	спинални игли №25	Игла спинална KD-Fine S 25G /0.53x88/	бр.	25	1.14	36 1	25	1.44 150/900925	KDM - Германия	0.60
об.поз.№137 6	спинални игли L90 №25 за кръвна картина с EDTA, к-т с лвер конус от 2 до 5 мл.	Игла спинална KD-Fine S 25G /0.53x88/	бр.	150	1.14	216 1	150	1.44 150/900925	KDM - Германия	3.60
об.поз.№140 1	за серум, к-т с лвер конус от 4 до 8 мл.	Епруветка, V EDTA, 2.6 мл. с етикет	бр.	700	14.52	10164 50	35000	0.2904 5512	КАВЕ-Германия	169.40
об.поз.№140 2		Епруветка, V серум, 7.5 мл.	бр.	800	14.52	11616 50	40000	0.2904 5031	КАВЕ-Германия	193.60
об.поз.№140 2	Sodium Heparin - 4 ml	Епруветка, NaN 4 мл.	бр.	20	15.18	303.6 50	1000	0.3036 7031	КАВЕ-Германия	5.06
об.поз.№140 4	за коагулация, к-т с лвер конус от 2 до 3 мл.	Епруветка, V коагулация, 2.9мл. с етикет	бр.	500	15.3	7650 50	25000	0.306 6004	КАВЕ-Германия	127.50
об.поз.№140 5	за кръвно газов анализ с лит.хепарин 2.3 мл с лвер конус, стерилна	Епруветка LiH, 2.3 мл. за KGA стерилна	бр.	10	43.35	433.5 50	500	0.867 74400	КАВЕ-Германия	7.23
об.поз.№140 6	адаптер за абокати към системата	Адаптер, лвер	бр.	25	31.8	795 100	2500	0.318 9053	КАВЕ-Германия	13.25
об.поз.№140 7	адаптер за инжекции към системата	Адаптер, инжекционен	бр.	20	32.16	643.2 100	2000	0.3216 9509	КАВЕ-Германия	10.72
об.поз.№140 8	игли с адаптер за затворена система, стерилни 20G	Игла с адаптер, V 20G, стерилен комплект	бр.	150	31.2	4680 100	15000	0.312 9002	КАВЕ-Германия	78.00
об.поз.№140 9	игли с адаптер за затворена система, стерилни 21G11/2	Игла с адаптер, V 21G, стерилен комплект	бр.	200	31.2	6240 100	20000	0.312 9010	КАВЕ-Германия	104.00
об.поз.№141 1	абокат №16	Абокати/катетър за периф.веноз.път KD-FIX 16 G-FEP сив/оп.50бр./1000 каш.	бр.	32	16.5	528 50	1600	0.33 150/762165/F	KDM - Германия	8.80
об.поз.№141 2	абокат №18	Абокати/катетър за периф.веноз.път KD-FIX 18 G-FEP зелен/оп.50бр./100 каш.	бр.	200	16.5	3300 50	10000	0.33 150/762169/F	KDM - Германия	55.00
об.поз.№141 3	абокат №20	Абокати/катетър за периф.веноз.път KD-FIX 20 G-FEP розов/оп.50бр./100 каш.	бр.	800	16.5	13200 50	40000	0.33 150/762202/F	KDM - Германия	220.00

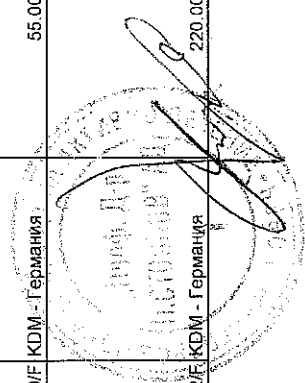


об.поз.№141	4	абокат №22	Абокат/катетър за периф.веноз.път KD-FIX 22 G-FER син/оп.50бр./1000 каш.	бр.	300	16.5	4950	50	15000	0.33	150/762226F	KDM - Германия	82.50
об.поз.№141	5	абокат №24	Абокат/катетър за периф.веноз.път KD-FIX 24 G-FER жълт/оп.50бр./10 каш.	бр.	200	18	3600	50	10000	0.36	150/762240F	KDM - Германия	60.00
об.поз.№141	6	бътерфлайки №23	Катетър Бътерфлай KD Fly 23G син лвер лок с капачка	бр.	300	0.12	36	1	300	0.12	150/742303	KDM - Германия	0.60
об.поз.№141	7	бътерфлайки №25	Катетър Бътерфлай KD Fly 25G жълт лвер лок с капачка	бр.	300	0.12	36	1	300	0.12	150/742501	KDM - Германия	0.60
об.поз.№141	8	капачки за абокати - стерилни	Капачки за абокати и трипътни кранчета KD-SAP/оп.200бр./каш.8000/	бр.	50	13.2	660	200	10000	0.066	150/762530	KDM - Германия	11.00
об.поз.№146	1	конец дебелина 2/0 дължина 6x45 см за лигатура в опаковка	Marlin 6x45, 2/0	дуз.	73	84.24	6149.52	стер. оп./	73	84.24	17240027	Cat gut-Германия	102.49
об.поз.№146	2	конец дебелина 0 дължина 2x90 см за лигатура в опаковка	Marlin 2x90, 0	дуз.	73	72	5256	стер. оп./	73	72	17240288	Cat gut-Германия	87.60
об.поз.№146	3	конец дебелина 0 дължина 7x75 см за лигатура в опаковка	Marlin 7x70, 0	дуз.	73	165.24	12062.52	стер. оп./	73	165.24	17240365	Cat gut-Германия	201.04
об.поз.№146	4	конец дебелина 1 дължина 6x45 см за лигатура в опаковка	Marlin 6x45, 1	дуз.	73	111.6	8146.8	стер. оп./	73	111.6	17240043	Cat gut-Германия	135.78
об.поз.№146	5	конец дебелина 1 дължина 2x90 см за лигатура в опаковка	Marlin 2x90, 1	дуз.	73	73.2	5343.6	стер. оп./	73	73.2	17240290	Cat gut-Германия	89.06
об.поз.№146	6	конец дебелина 2 дължина 5x70 см за лигатура в опаковка	Marlin 5x70, 2	дуз.	73	169.2	12351.6	стер. оп./	73	169.2	17240351	Cat gut-Германия	205.86
об.поз.№146	7	конец дебелина 2 дължина 2x90 см за лигатура в опаковка	Marlin 2x90, 2	дуз.	73	90.72	6622.56	стер. оп./	73	90.72	17240284	Cat gut-Германия	110.38
об.поз.№153	1	конец дебелина 3/0 дължина 70 см игла тяло кръгла форма 1/2 обиколка 17	Polyester-S green HR17 3/0, 70	бр.	36	33.48	1205.28	12	452	2.79	17212952	Cat gut-Германия	20.09

об.поз. №153	2	конец дебелина 2/0 дължина 70 см игла тяло кръгла форма 1/2 обиколка 22	бр.				36	32.4	1166.4	12	432	2.7	17213037	Cat gut-Германия	19.44
об.поз. №153	3	конец дебелина 0 дължина 70 см игла тяло кръгла форма 1/2 обиколка 30	бр.				36	32.4	1166.4	12	432	2.7	17213185	Cat gut-Германия	19.44
об.поз. №153	4	конец дебелина 3/0 дължина 70 см игла тяло режеща форма 1/2 обиколка 20	бр.				36	36.36	1308.96	12	432	3.03	17213509	Cat gut-Германия	21.82
об.поз. №153	5	конец дебелина 3/0 дължина 70 см игла тяло режеща форма ски- образно обиколка 22	бр.				36	103.32	3719.52	12	432	8.61	17218654	Cat gut-Германия	61.99
об.поз. №153	6	конец дебелина 2/0 дължина 70 см игла тяло режеща форма 1/2 обиколка 26	бр.				36	34.2	1231.2	12	432	2.85	17213525	Cat gut-Германия	20.82
об.поз. №153	7	конец дебелина 3/0 дължина 70 см игла тяло режеща форма 3/8 обиколка 16	бр.				36	34.92	1257.12	12	432	2.91	17213320	Cat gut-Германия	20.95
об.поз. №153	8	конец дебелина 3/0 дължина 70 см игла тяло режеща форма 3/8 обиколка 19	бр.				36	33.84	1218.24	12	432	2.82	17213347	Cat gut-Германия	20.30
об.поз. №153	9	конец дебелина 2/0 дължина 70 см игла тяло режеща форма 3/8 обиколка 30	бр.				36	34.2	1231.2	12	432	2.85	17213401	Cat gut-Германия	20.52
об.поз. №153	10	конец дебелина 0 дължина 70 см игла тяло режеща форма 3/8 обиколка 30	бр.				36	34.56	1244.16	12	432	2.88	17213410	Cat gut-Германия	20.74
об.поз. №154	1	конец дебелина 4/0 дължина 70 см игла тяло режеща форма 3/8 обиколка 12	бр.				6	36.36	218.16	12	72	3.03	17214815	Cat gut-Германия	3.64
об.поз. №154	2	конец дебелина 3/0 дължина 70 см игла тяло режеща форма 1/2 обиколка 15	бр.				12	36	432	12	144	3	17214980	Cat gut-Германия	7.20
об.поз. №154	3	конец дебелина 1 дължина 70 см игла тяло режеща форма 1/2 обиколка 30	бр.				6	34.2	205.2	12	72	2.85	17214866	Cat gut-Германия	3.42
об.поз. №154	4	конец дебелина 1 дължина 70 см игла тяло режеща форма 1/2 обиколка 30	бр.				6	34.56	207.36	12	72	2.88	17215021	Cat gut-Германия	3.46
об.поз. №154	5	конец монофилментен 5/0 70 см. режеща игла 1/2 16 мм	бр.				15	49.68	745.2	12	180	4.14	Sonderartikel	Cat gut-Германия	12.42
об.поз. №155	1	Еднократен автоматичен инструмент за биопсия на меки тъкани дебелина G16, дължина 16см	бр.				10	50.4	504	1	10	50.4	COLT 1615	Sterylab-Италия	8.40

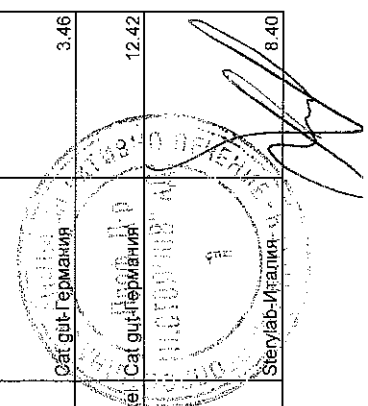


об.поз.№156	2	Еднократен автоматичен инструмент за биопсия на меки тъкани дебелина G16, Дължина 20см	COLT – еднократен автоматичен инструмент за биопсия на меки тъкани	бр.	10	50.4	504 1	10	50.4	CLT1620	Steylab-Италия	8.40
об.поз.№156	3	Еднократен автоматичен инструмент за биопсия на меки тъкани дебелина G18, Дължина 16см	COLT – еднократен автоматичен инструмент за биопсия на меки тъкани	бр.	10	50.4	504 1	10	50.4	CLT1815	Steylab-Италия	8.40
об.поз.№156	4	Еднократен автоматичен инструмент за биопсия на меки тъкани дебелина G18, Дължина 20см	COLT – еднократен автоматичен инструмент за биопсия на меки тъкани	бр.	10	50.4	504 1	10	50.4	CLT1820	Steylab-Италия	8.40
об.поз.№160	1	Дренаж по кер №8	Кер дренаж	бр.	10	15.3	153 1	10	15.3	GC3009	Coloplast-Porges - Д	2.55
об.поз.№160	2	Дренаж по кер №10	Кер дренаж	бр.	10	15.3	153 1	10	15.3	GC3010	Coloplast-Porges - Д	2.55
об.поз.№160	3	Дренаж по кер №12	Кер дренаж	бр.	10	15.3	153 1	10	15.3	GC3012	Coloplast-Porges - Д	2.55
об.поз.№160	4	Дренаж по кер №14	Кер дренаж	бр.	10	15.3	153 1	10	15.3	GC3014	Coloplast-Porges - Д	2.55
об.поз.№160	5	Дренаж по кер №16	Кер дренаж	бр.	10	15.3	153 1	10	15.3	GC3016	Coloplast-Porges - Д	2.55
об.поз.№160	6	Дренаж по кер №18	Кер дренаж	бр.	10	15.3	153 1	10	15.3	GC3018	Coloplast-Porges - Д	2.55
об.поз.№160	7	Дренаж по кер №20	Кер дренаж	бр.	10	15.3	153 1	10	15.3	GC3020	Coloplast-Porges - Д	2.55
об.поз.№173	1	катетър уретерален връх олива с полиестерно стиле, два отвора №4	катетър уретерален връх олива с полиестерно стиле, два отвора №4	бр.	100	10.2	1020 1	100	10.2	AC5104	Coloplast-Porges - Д	17.00
об.поз.№173	2	катетър уретерален връх олива с полиестерно стиле, два отвора №5	катетър уретерален връх олива с полиестерно стиле, два отвора №5	бр.	100	10.2	1020 1	100	10.2	AC5105	Coloplast-Porges - Д	17.00
об.поз.№173	3	катетър уретерален връх свирка с полиестерно стиле, два отвора №4	катетър уретерален връх свирка с полиестерно стиле, два отвора №4	бр.	100	12	1200 1	100	12	AC5204	Coloplast-Porges - Д	20.00
об.поз.№173	4	катетър уретерален връх свирка с полиестерно стиле, два отвора №5	катетър уретерален връх свирка с полиестерно стиле, два отвора №5	бр.	100	12	1200 1	100	12	AC5205	Coloplast-Porges - Д	20.00
об.поз.№175	1	катетър двупътен фолиев с балон 5-15мл. връх силиконов №14	Silic Foley Cath 5/15ml /5	бр.	25	6	150 1	25	6	AA6114	Coloplast-Porges - Д	2.50
об.поз.№175	2	катетър двупътен фолиев с балон 5-15мл. връх силиконов №16	Silic Foley Cath 5/15ml /5	бр.	70	6	420 1	70	6	AA6116	Coloplast-Porges - Д	7.00
об.поз.№175	3	катетър двупътен фолиев с балон 5-15мл. връх силиконов №18	Silic Foley Cath 5/15ml /5	бр.	70	6	420 1	70	6	AA6118	Coloplast-Porges - Д	7.00
об.поз.№175	4	катетър двупътен фолиев с балон 5-15мл. връх силиконов №20	Silic Foley Cath 5/15ml /5	бр.	70	6	420 1	70	6	AA6120	Coloplast-Porges - Д	7.00


об.поз.№175	5	катетър двупътен фолиев с балон 5-15мл. връх силиконов №22	бр.	25	6	150	1	25	6	AA6122	Coloplast-Porges - Д	2,50
об.поз.№176	1	катетър за TUR трипътен оперативен с балон 50мл. връх SOUVELAIRE, с хидрофилно покритие, силиконов №22	бр.	20	23.94	478.8	1	20	23.94	XB6122	Coloplast-Porges - Д	7.98
об.поз.№176	2	катетър за TUR трипътен оперативен с балон 50мл. връх SOUVELAIRE, с хидрофилно покритие, силиконов №24	бр.	100	23.94	2394	1	100	23.94	XB6124	Coloplast-Porges - Д	39.90
об.поз.№177	1	катетър за TUR трипътен оперативен с балон 50мл. връх DUFOUR, с хидрофилно покритие, силиконов №22	бр.	20	23.94	478.8	1	20	23.94	XB6322	Coloplast-Porges - Д	7.98
об.поз.№177	2	катетър за TUR трипътен оперативен с балон 50мл. връх DUFOUR, силиконов №24	бр.	100	23.94	2394	1	100	23.94	XB6324	Coloplast-Porges - Д	39.90
об.поз.№180	1	катетър "пецер" №18	бр.	300	8.58	2574	1	300	8.58	AE3A18	Coloplast-Porges - Д	42.90
об.поз.№180	2	катетър "пецер" №20	бр.	400	8.58	3432	1	400	8.58	AE3A20	Coloplast-Porges - Д	57.20
об.поз.№180	3	катетър "пецер" №22	бр.	400	8.58	3432	1	400	8.58	AE3A22	Coloplast-Porges - Д	57.20
об.поз.№180	4	катетър "пецер" №24	бр.	400	8.58	3432	1	400	8.58	AE3A24	Coloplast-Porges - Д	57.20
об.поз.№180	5	катетър "пецер" №26	бр.	150	8.58	1287	1	150	8.58	AE3A26	Coloplast-Porges - Д	21.45
об.поз.№180	6	катетър "пецер" №28	бр.	150	8.58	1287	1	150	8.58	AE3A28	Coloplast-Porges - Д	21.45
об.поз.№180	7	катетър "пецер" №30	бр.	50	8.58	429	1	50	8.58	AE3A30	Coloplast-Porges - Д	7.15
об.поз.№180	8	катетър "пецер" №32	бр.	50	8.58	429	1	50	8.58	AE3A32	Coloplast-Porges - Д	7.15
об.поз.№181	1	катетър бърбечен №6/ връх цилиндричен полиестерно стиле с 2 отвора	бр.	200	8.88	1776	1	200	8.88	AC5006	Coloplast-Porges - Д	29.60
об.поз.№181	2	катетър бърбечен №7/ връх цилиндричен полиестерно стиле с 2 отвора	бр.	50	8.88	444	1	50	8.88	AC5007	Coloplast-Porges - Д	4.40

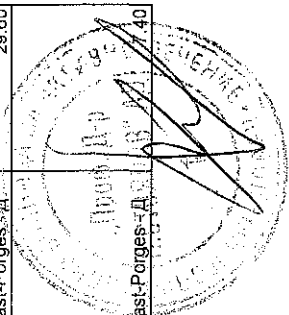


об.поз.№181	3	категър бърчен №8	категър бърчен №8/ връх цилиндричен полиестерно стиле с 2 отвора	бр.	40	8.88	355.2	1	40	8.88	AC5008	Coloplast-Porges - Д	5.92
об.поз.№184	1	категър цистофикс №14	Set Cystodain N09	бр.	15	37.8	567	1	15	37.8	BJ8009	Coloplast-Porges - Д	9.45
об.поз.№184	2	категър цистофикс №16	Set Cystodain N12	бр.	15	37.8	567	1	15	37.8	BJ8012	Coloplast-Porges - Д	9.45
об.поз.№184	3	категър цистофикс №18	Set Cystodain N15	бр.	15	37.8	567	1	15	37.8	BJ8015	Coloplast-Porges - Д	9.45
об.поз.№184	4	категър за нефростома силиконов №18	категър силиконов с 2 отвора над балона, за нефростома, N18	бр.	24	34.2	820.8	1	24	34.2	AJ6618	Coloplast-Porges - Д	13.68
об.поз.№184	5	категър за нефростома силиконов №20	категър силиконов с 2 отвора над балона, за нефростома, N20	бр.	50	34.2	1710	1	50	34.2	AJ6620	Coloplast-Porges - Д	28.50
об.поз.№188	1	уретерален стент "Дъбълджей" №4	уретерален стент "Дъбълджей", пол иуретан, затворен връх, 4.8Сп	бр.	5	38.4	192	1	5	38.4	BNBB55	Coloplast-Porges - Д	3.20
об.поз.№188	2	уретерален стент "Дъбълджей" №6/28см	уретерален стент "Дъбълджей", пол иуретан, затворен връх, 6Сп/28см	бр.	15	38.4	576	1	15	38.4	BNBB65	Coloplast-Porges - Д	9.60
об.поз.№188	3	уретерален стент "Дъбълджей" №7/28см	уретерален стент "Дъбълджей", пол иуретан, затворен връх, 7Сп/28см	бр.	20	38.4	768	1	20	38.4	BNBB75	Coloplast-Porges - Д	12.80
об.поз.№188	4	уретерален стент "Дъбълджей" №8/28см	уретерален стент "Дъбълджей", пол иуретан, затворен връх, 7Сп/28см	бр.	25	38.4	960	1	25	38.4	BNBB85	Coloplast-Porges - Д	16.00
об.поз.№200	1	ръквичи аутоглонни №6.5 или S	ръквичи нестерилни ДЕРМАГРИП HIGH RISK латексови без пудра сини S (№ 6-6.5) оп.50бр./каш.100 п./	бр.	14.4	18	259.2	50	720	0.36	128/D14- 1401	WIP - Мерказия	4.32

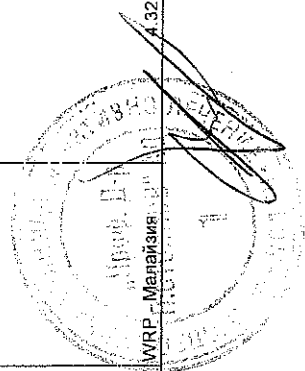


об. поз. №200 2	Ръкавици аутопсионни №7 или M	Ръкавици нестерилни ДЕРМАТРИП HIGH RISK латексови без пудра сини M(№ 7-7.5) оп. 50бр./каш.10о п./	бр.	14.4	18	259.2 50	720	0.36 1402	128/D14-1402	WRP - Малайзия	4.32
об. поз. №200 3	Ръкавици аутопсионни №7.5 или L	Ръкавици нестерилни ДЕРМАТРИП HIGH RISK латексови без пудра сини M(№ 7-7.5) оп. 50бр./каш.10о п./	бр.	14.4	18	259.2 50	720	0.36 1402	128/D14-1402	WRP - Малайзия	4.32
об. поз. №200 4	Ръкавици аутопсионни №8 или XL	Ръкавици нестерилни ДЕРМАТРИП HIGH RISK латексови без пудра сини L (№ 8-8.5) оп. 50бр./каш.10о п./	бр.	14.4	18	259.2 50	720	0.36 1403	128/D14-1403	WRP - Малайзия	4.32
об. поз. №200 5	Ръкавици аутопсионни №8.5 или XXL	Ръкавици нестерилни ДЕРМАТРИП HIGH RISK латексови без пудра сини L (№ 8-8.5) оп. 50бр./каш.10о п./	бр.	14.4	18	259.2 50	720	0.36 1403	128/D14-1403	WRP - Малайзия	4.32
об. поз. №200 6	Ръкавици аутопсионни №9	Ръкавици нестерилни ДЕРМАТРИП HIGH RISK латексови без пудра сини XL(№ 9) оп. 50бр./каш.10о п./	бр.	14.4	18	259.2 50	720	0.36 1404	128/D14-1404	WRP - Малайзия	4.32
об. поз. №200 7	стерилни ръкавици 3/4 дължина №7.5	Ръкавици стерилни ДЕРМАТРИП ELBOW латексови без пудра M (№ 7.5) D 3975-15	бр.	10	7.8	78.2	20	3.9 3975	128/D15-3975	WRP - Малайзия	1.30
об. поз. №203 203	203 Игли за епидурална анестезия №18	203 Игли за епидурална анестезия №18	бр.	50	5.76	288.1	50	5.76 1150-6K081	1150-6K081	Райлнк-Германия	4.80
об. поз. №217 1	Трахеостомни канюли с балон №7	Трахеостомна канюла с балон с ниско налягане №7	бр.	30	14.4	432.1	30	14.4 31-7000	31-7000	SUMI-Полша	7.20

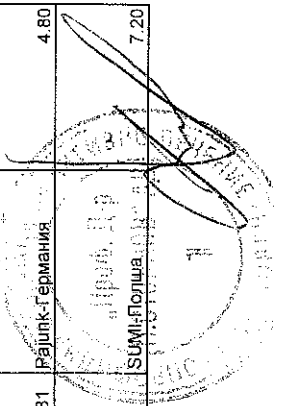


об.поз.№217	2	Трахеостомни канюли с балон №7.5	Трахеостомна канюла с балон с ниско налягане N7.5	бр.	30	14.4	432	1	30	14.4	31-7500	SUMI-Полша	7.20
об.поз.№217	3	Трахеостомни канюли с балон №8	Трахеостомна канюла с балон с ниско налягане N8	бр.	30	14.4	432	1	30	14.4	31-8000	SUMI-Полша	7.20
об.поз.№217	4	Трахеостомни канюли с балон №8.5	Трахеостомна канюла с балон с ниско налягане N8.5	бр.	30	14.4	432	1	30	14.4	31-8500	SUMI-Полша	7.20
об.поз.№217	5	Трахеостомни канюли с балон №9	Трахеостомна канюла с балон с ниско налягане N9	бр.	30	14.4	432	1	30	14.4	31-9000	SUMI-Полша	7.20
об.поз.№221	1	Фиксатор за трахеална тръба педиатричен 4.0 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, педиатричен 4.0 мм - Ендофикс Baby	бр.	10	6.84	68.4	1	10	6.84	40-1005-040	VBM-Германия	1.14
об.поз.№221	2	Фиксатор за трахеална тръба педиатричен 4.5 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 4.5 мм - Ендофикс Орал II	бр.	10	6.84	68.4	1	10	6.84	40-9006-010	VBM-Германия	1.14
об.поз.№221	3	Фиксатор за трахеална тръба педиатричен 5.0 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 5.0 мм - Ендофикс Орал II	бр.	10	6.84	68.4	1	10	6.84	40-9006-010	VBM-Германия	1.14
об.поз.№221	4	Фиксатор за трахеална тръба 4.5 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 4.5 мм - Ендофикс Орал II	бр.	50	6.84	342	1	50	6.84	40-9006-010	VBM-Германия	5.70
об.поз.№221	5	Фиксатор за трахеална тръба 5.0мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 5.0 мм - Ендофикс Орал II	бр.	50	6.84	342	1	50	6.84	40-9006-010	VBM-Германия	5.70
об.поз.№221	6	Фиксатор за трахеална тръба 5.5 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 5.5 мм - Ендофикс Орал II	бр.	50	6.84	342	1	50	6.84	40-9006-010	VBM-Германия	5.70
об.поз.№221	7	Фиксатор за трахеална тръба 6.0 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 6.0 мм - Ендофикс Орал II	бр.	100	6.84	684	1	100	6.84	40-9006-010	VBM-Германия	11.40
об.поз.№221	8	Фиксатор за трахеална тръба 6.5 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 6.5 мм - Ендофикс Орал II	бр.	400	6.84	2736	1	400	6.84	40-9006-030	VBM-Германия	45.60
об.поз.№221	9	Фиксатор за трахеална тръба 7.0 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 7.0 мм - Ендофикс Орал III	бр.	600	6.84	4104	1	600	6.84	40-9006-030	VBM-Германия	68.40

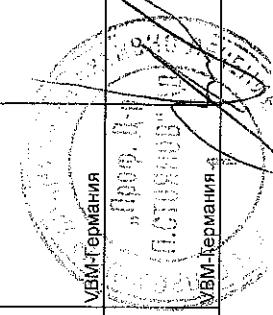


об.поз.№221 10	Фиксатор за трахеална тръба 7.5 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 7.5 мм - Ендофикс Орап II бр.	600	6.84	4104 1	600	6.84	600	6.84	40-9006-030	VBM-Германия	68.40
об.поз.№221 11	Фиксатор за трахеална тръба 8.0 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 8.0 мм - Ендофикс Орап II бр.	100	6.84	684 1	100	6.84	100	6.84	40-9006-030	VBM-Германия	11.40
об.поз.№221 12	Фиксатор за трахеална тръба 8.5 мм	Фиксатор за ендотрахеална тръба, 8.5 мм - Ендофикс Орап II бр.	50	6.84	342 1	50	6.84	50	6.84	40-9006-040	VBM-Германия	5.70
об.поз.№223 1	пациентен шланг/шланг/дихателен шланг/ 60см.	пациентен шланг/дихателен шланг/ 60см.	10	60	600 1	10	60	10	60	6622060	VBM-Германия	10.00
об.поз.№223 2	пациентен шланг/дихателен шланг/ 80см.	пациентен шланг/дихателен шланг/ 80см.	20	75.3	1506 1	20	75.3	20	75.3	6622080	VBM-Германия	25.10
об.поз.№223 3	пациентен шланг/дихателен шланг/ 110см.	пациентен шланг/дихателен шланг/ 110см.	20	108	2160 1	20	108	20	108	6622110	VBM-Германия	36.00
об.поз.№223 4	пациентен шланг/дихателен шланг/ 150см.	пациентен шланг/дихателен шланг/ 150см.	20	133.2	2664 1	20	133.2	20	133.2	6622150	VBM-Германия	44.40
об.поз.№223 5	У-конектор за шлангове	У-конектор, прав 15мм I.D/22мм O.D	20	13.65	273 1	20	13.65	20	13.65	6011200	VBM-Германия	4.55
об.поз.№223 6	У-конектор за пациентен шланг	У-конектор, прав 15мм I.D/22мм O.D	20	13.65	273 1	20	13.65	20	13.65	6010100	VBM-Германия	4.55
об.поз.№223 7	еднократен шланг за обдишване - P180	еднократен шланг за обдишване - P180	20	15.3	306 1	20	15.3	20	15.3	9508	Fazzini-Италия	5.10
об.поз.№225 1	трилменен катетър 7.5Fг 20см	трилменен катетър 7.0Fг 20см - TriuCath	20	42	840 1	20	42	20	42	323-027	Intra-Германия	14.00
об.поз.№225 2	трилменен катетър 12.0Fг 20см	трилменен катетър 12.0Fг 20см - TriuCath hemodialysis	20	42	840 1	20	42	20	42	323-212	Intra-Германия	14.00
об.поз.№225 3	четирилменен катетър 8.5Fг 20см	четирилменен катетър 8.5Fг 20см - Quadrocath	20	54	1080 1	20	54	20	54	334-028	Intra-Германия	18.00
об.поз.№227 1	Трахеостомни канюли с два балона №7	Трахеостомна с два балона N7	20	41.4	828 1	20	41.4	20	41.4	32-7000	SUMI-Полша	13.80
об.поз.№227 2	Трахеостомни канюли с два балона №7.5	Трахеостомна с два балона N7.5	20	41.4	828 1	20	41.4	20	41.4	32-7500	SUMI-Полша	13.80
об.поз.№227 3	Трахеостомни канюли с два балона №8	Трахеостомна с два балона N8	20	41.4	828 1	20	41.4	20	41.4	32-8000	SUMI-Полша	13.80
об.поз.№227 4	Трахеостомни канюли с два балона №8.5	Трахеостомна с два балона N8.5	20	41.4	828 1	20	41.4	20	41.4	32-8500	SUMI-Полша	13.80

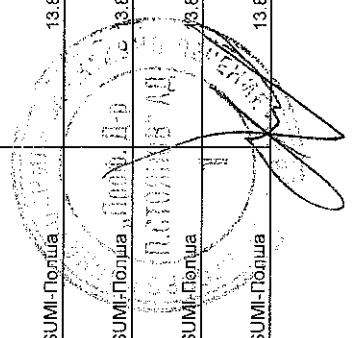

об.поз.№227	5	Трахесостомни каноли с два балона №9	Канола Трахесостомна с два балона №9	бр.	20	41.4	828 1		20	41.4 32-9000	SUMI-Полша	13.80
об.поз.№227	6	Трахесостомни каноли с два балона №10	Канола Трахесостомна с два балона №10	бр.	20	41.4	828 1		20	41.4 32-1000	SUMI-Полша	13.80
об.поз.№229	1	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /ляв бронх/ тип карленс №37	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /ляв бронх/ тип карленс №37	бр.	3	82.8	248.4 1		3	82.8 21-3741	SUMI-Полша	4.14
об.поз.№229	2	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /ляв бронх/ тип карленс №39	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /ляв бронх/ тип карленс №39	бр.	3	82.8	248.4 1		3	82.8 21-3941	SUMI-Полша	4.14
об.поз.№229	3	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /ляв бронх/ тип карленс №41	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /ляв бронх/ тип карленс №41	бр.	3	82.8	248.4 1		3	82.8 21-4141	SUMI-Полша	4.14
об.поз.№229	4	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /десен бронх/ тип карленс №37	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /десен бронх/ тип карленс №37	бр.	3	86.4	259.2 1		3	86.4 22-3741	SUMI-Полша	4.32
об.поз.№229	5	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /десен бронх/ тип карленс №39	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /десен бронх/ тип карленс №39	бр.	3	86.4	259.2 1		3	86.4 22-3941	SUMI-Полша	4.32
об.поз.№229	6	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /десен бронх/ тип карленс №41	Двойнолуменна ендотрахиална тръба /десен бронх/ тип карленс №41	бр.	3	86.4	259.2 1		3	86.4 22-4141	SUMI-Полша	4.32
об.поз.№248	1	микропруветки 1 мл за кръвна захар	Микропруветка за кръвна захар ESAT KB+EK	бр.	150	40	6000 100		15000	0.4 025411	KABE-Германия	100.00
об.поз.№248	2	пруветки стандарт за кръвна захар 12 ммол/л	Микропруветка 2мл. стандарт глюкоза	бр.	8	72	576 100		800	0.72 083038	KABE-Германия	9.60
об.поз.№248	3	реактив глюкоза - туба 5л. хартия за принтер 80 мм,	Системен разтвор за глюкоанализатор Термо хартия 80 мм,	литър	5	360	1800 5		25	72 016008	KABE-Германия	30.00
об.поз.№248	4	мембрана ензимна за глюкоанализатор	Ензимна мембрана	бр.	20	3.6	72 1		20	3.6 016003	KABE-Германия	1.20
об.поз.№248	5	шляух силиконов с дължина 50мм	шляух силиконов с дължина 50мм	бр.	2	198.5	397 1		2	198.5 096046	KABE-Германия	6.62
об.поз.№248	6	шляух силиконов с дължина 45мм	шляух силиконов с дължина 45мм	бр.	2	58	116 1		2	58 86018	KABE-Германия	1.93
об.поз.№248	7	помпен шляух с дължина 165см	шляух силиконов помпен	бр.	2	58	116 1		2	58 86017	KABE-Германия	1.93
об.поз.№248	8	уплътнение за миещо устройство	шляух силиконов уплътнение за миещо устройство	бр.	2	112.2	224.4 1		2	112.2 86025	KABE-Германия	3.74
об.поз.№248	9	уплътнение за електрода	уплътнение за миещо устройство	бр.	2	125	250 1		2	125 86032	KABE-Германия	4.17
об.поз.№248	10	уплътнение за електрода	уплътнение за електрода	бр.	2	98.4	196.8 1		2	98.4 86510	KABE-Германия	3.28

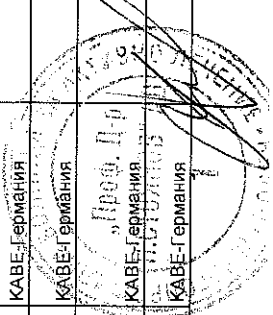

345	345. Кит Елайза Borrelia IgM - спектрофотометър Мерлин отчитане	Borrelia Burgdorf. IgM	бр.	5	315	1575	1	5	315	ESR121M	Virion/Seion-Герман	26.25
346	346. Кит Елайза Borrelia IgG - спектрофотометър Мерлин отчитане	Borrelia Burgdorf. IgG	бр.	5	280	1400	1	5	280	ESR121G	Virion/Seion-Герман	23.33
351	351. Абсолютен алкохол 99'	Абс. алкохол 99 % - Dehuol	литър	80	32.2	2576	2.5 л/оп.	200	12.88	06-10077Q	Вю- Оптика - Италия	42.93
352	352. Етилов алкохол	Dehuol 95	литър	120	24.37	2924	4.2.5 л/оп.	300	9.748	06-10070Q	Вю- Оптика - Италия	48.74
355	355. Ксипол	Ксипол	литър	3	80	240	10	30	8	341010	Avantor-Mallinckrodt	4.00
358	358. Формалин с неутрално рН	Формалин 10 %, буферизиран неутрален	литър	15	39	585	10	150	3.9	3933/10	Avantor-Mallinckrodt	9.75
Обос. позиция 1	Номенклатура 2	Генерика/група 3	Форма на продукта 5	Количество /концентрат/ 6	Предлагана опаковка 7	Ед. цена за 1л. раб. р-р 8	Ед. цена за 1л/кг концентрат 9	*Обща стойност 10	Ед. цена за опаковка 11	Брой опаковки 12	Производител 13	0
374	374. Препарат за инструменти - почистване на метален инструментариум, лаб. стъклария, ендоскопска апаратура (концентрат) без съдържание на ензими	Търговско наименование 4	литър	100	5	15.6	15.6	1560	78	20	Borer Chemie AG - Шв	26
382	382. Течен сапун с дезинфектант за ръце и кожа	Анисейф Савон	литър	300	5	4.32	4.32	1296	21.6	60	Anicos Laboratories -	21.6

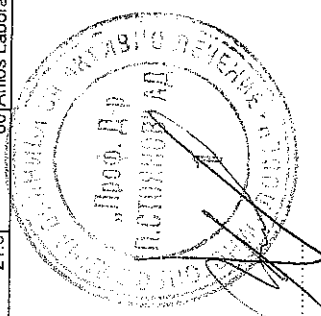

Исп. директор: /Д-р Тихомир Бенев/

278726.70

232272.25


4645.46

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обща прогнозна стойност с ДДС :

Обща прогнозна стойност без ДДС :

Обща стойност на гаранцията :

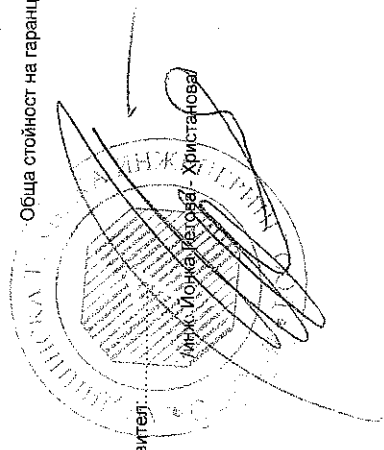

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител: